


## マニーアイド縫合針 / MANI SURGICAL EYED NEEDLES


マニーアイド縫合針は歯科用であり、針単体で販売いたします。

角針 ▲  
逆角針 ▽

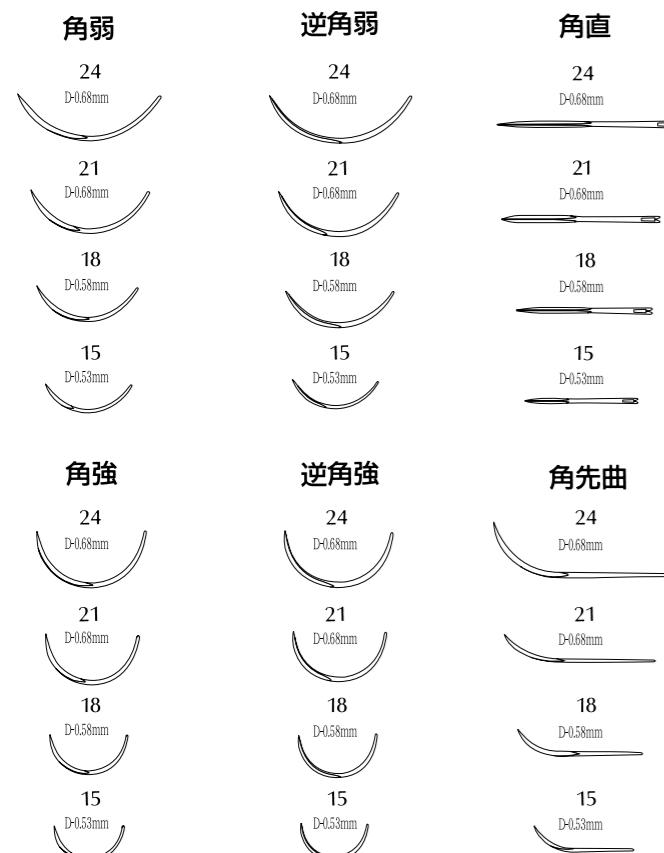

標準価格(10本入)全形態 2,400円  
2025年8月時点の税抜価格

### バネ孔(弾機孔)

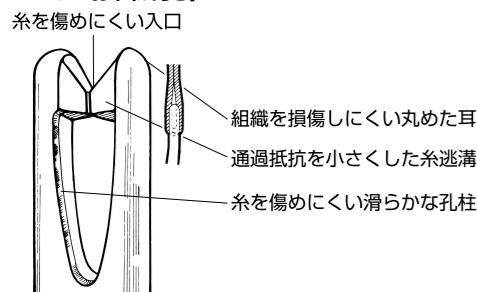

MANIのバネ孔(弾機孔)は、縫合組織を傷めにくい丸めた耳、通過抵抗を少なくする糸逃溝を有していると共に、糸を損傷しない糸入口となめらかな孔柱でありますので、ナミ孔(普通孔)の必要性を感じさせません。

●耐蝕性に優れ、適度な韌性と硬度を併せ持った「マニーハードファイバーステンレススチール」を採用。

**注意** 縫合針のご使用に際して ●本製品は医療機器です。縫合以外の目的には使用しないでください。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●本製品の再使用は行わないで下さい。●針折れ、糸切れの原因になりますので、バネ孔部近くは把持しないで下さい。●持針器は使用前に適したサイズ、機能のものをご使用下さい。●予め患者の口腔外で変形、キズ等が無いか確認して下さい。変形した針、キズの付いた針は折れの原因となりますので、使用しないで下さい。●針刺し事故に充分注意してご使用下さい。●ご使用後は医療廃棄物として適切な処理をして下さい。

製品ご使用前に電子添文を必ずお読みください。

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3  
【デンタル国内営業】Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593  
URL:<http://www.mani.co.jp>

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 〒564-8650 大阪吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525  
東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161

D01334

Healthy teeth, happy smiles,  
to the world.



医療機器承認番号 20900BZZ000869000  
高度管理医療機器 一般的名称：滅菌済み縫合糸  
販売名 マニーシルク  
医療機器承認番号 21100BZZ000049000  
高度管理医療機器 一般的名称：ポリアミド縫合糸  
販売名 マニーナイロン  
医療機器承認番号 21100BZZ000050000  
高度管理医療機器 一般的名称：ポリエチル縫合糸  
販売名 マニーポリエチル

# 滅菌済針付縫合糸 / MANI SUTURES

滅菌済針付縫合糸はアイレス針を用いています。本品は歯科用であり、縫合糸付で販売いたします。

注文番号	縫合針			縫合糸			
	種類	針形状	弯曲	針長	USPサイズ	最小／最大 (直径mm)	材質 全長
1	逆三角	強弯	▼	RH-18mm D-0.43mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
2	逆三角	強弯	▼	RH-25mm D-0.73mm	3-0	0.20/0.249	シルク ブラックブレイド 45cm
3	逆三角	弱弯	▼	RE-18mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
4	先端角	強弯	□	YH-18mm D-0.38mm	5-0	0.10/0.149	ポリエチル グリーンブレイド 45cm
5	先端角	強弯	□	YH-18mm D-0.53mm	3-0	0.20/0.249	シルク ブラックブレイド 45cm
6	丸 (テーパー小)	直	□	TS-20mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
7	逆三角	弱弯	▼	RE-13mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックブレイド 45cm
8	逆三角	弱弯	▼	RE-18mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	ポリエチル グリーンブレイド 45cm
9	丸 (テーパー小)	強弯	□	TH-18mm D-0.43mm	5-0	0.10/0.149	ポリエチル グリーンブレイド 45cm
10	丸 (テーパー小)	強弯	□	TH-18mm D-0.53mm	3-0	0.20/0.249	シルク ブラックブレイド 45cm
11	丸 (テーパー小)	強弯	□	TH-16mm D-0.73mm	2-0	0.30/0.339	シルク ブラックブレイド 45cm
12	丸 (テーパー大)	釣針	□	AJ-16mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックブレイド 45cm
13	丸 (テーパー大)	釣針	□	AJ-16mm D-0.63mm	3-0	0.20/0.249	ナイロン ブラックブレイド 45cm
14	丸 (テーパー大)	強弯	□	AH-13mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
15	丸 (テーパー大)	強弯	□	AH-16mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックブレイド 45cm
16	丸 (テーパー大)	強弯	□	AH-16mm D-0.63mm	3-0	0.20/0.249	ナイロン ブラックブレイド 45cm
17	丸 (テーパー大)	強弯	□	AH-20mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
18	逆三角	弱弯	▼	RE-11mm D-0.43mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
19	逆三角	弱弯	▼	RE-13mm D-0.38mm	5-0	0.10/0.149	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
20	逆三角	弱弯	▼	D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm

注文番号	縫合針			縫合糸			
	種類	針形状	弯曲	針長	USPサイズ	最小／最大 (直径mm)	材質 全長
21	逆三角	強弯	▼	RH-16mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
22	逆三角	強弯	▼	RH-16mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
23	逆三角	弱弯	▼	RE-18mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
24	逆三角	弱弯	▼	RE-18mm D-0.58mm	3-0	0.20/0.249	シルク ブラックブレイド 45cm
25	丸 (テーパー小)	弱弯	□	TE-13mm D-0.43mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
26	丸 (テーパー小)	弱弯	□	TE-18mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
27	先端角	弱弯	□	YE-13mm D-0.43mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
28	先端角	強弯	□	YH-16mm D-0.48mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
29	先端角	弱弯	□	YE-18mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm



●逆三角針  
注文番号(NO.) : 1,2,3,7,8,18,19,20,21,22,23,24



●先端角針  
注文番号(NO.) : 4,5,27,28,29

弯曲の内側が三角形の底辺となる逆三角形断面であり、刃が弯曲の外側に付いています。主に硬く刺通しにくい組織に適しています。

丸針の先端を三角形の銳線にして刃を付けたため、組織の侵襲が少ないです。硬組織の縫合に適しています。



●丸針 (テーパー小)  
注文番号(NO.) : 6,9,10,11,25,26



●丸針 (テーパー大)  
注文番号(NO.) : 12,13,14,15,16,17

先端が細く鋭いので、主に柔らかい組織の縫合に適しています。

先端が太く曲がりに強いため、主に硬組織の縫合に適しています。


●耐蝕性に優れ、適度な韌性と硬度を併せ持った「マニーハードファイバーステンレススチール」を採用。

標準価格(12本入/箱) 全形態 5,800円

2025年8月時点の税抜価格



滅菌済針付縫合糸のご使用に際して  
●本製品は医療機器です。縫合以外の目的には使用しないでください。  
●本製品は滅菌品です。再滅菌はしないでください。  
●本製品の再使用は行わないで下さい。  
●針折れ、糸切れの原因になりますので、接合部近くは把持しないでください。  
●持針器は使用前に適したサイズ、機能のものを選択して下さい。  
●予め患者の口腔外で変形、キズ等が無いか確認して下さい。  
変形した針、キズの付いた針は折れの原因となりますので、使用しないで下さい。  
●針刺し事故に充分注意してご使用下さい。  
●ご使用後は医療廃棄物として適切な処理をして下さい。

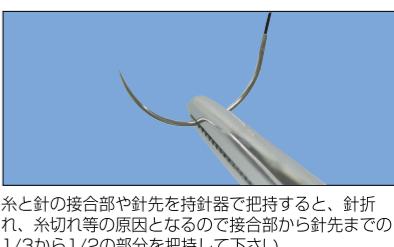

糸と針の接合部や針先を持針器で把持すると、針折れ、糸切れ等の原因となるので接合部から針先までの1/3から1/2の部分を把持して下さい。

製品ご使用前に電子添文を必ずお読みください。